meditrade

ZiboCare®
Denmark

Kikuhime trykmåler

Brugervejledning

Kalibrering

På grund af ændringer i det atmosfæriske tryk bør måleren ved opstart kalibreres, hvis værdien på displayet er mere end +/- 1 mmHg.

1. For at udføre en 0 mmHg-kalibrering skal der tændes for måleren, uden at sensoren er tilsluttet. Tryk på knappen "Power".
2. Kontrollér at trykangivelsen er +/- mmHg på displayet.
3. Hvis der er behov for justering, benyttes den lille gule skruetrækker til at dreje på justeringsskruen (findes øverst på apparatet), indtil der vises 0 mmHg. Drej forsigtigt.
4. Apparatet er nu kalibreret.

Tilslutning

1. Tilslut slangen med 3-vejsventilen til apparatet (Fig 1).
2. Tilslut derefter den valgte sensoren (ballon) til 3-vejsventilen ved hjælp af Luer Lock
3. Luk 3-vejsventilen (Fig. 3). Apparatet er nu klar til brug.

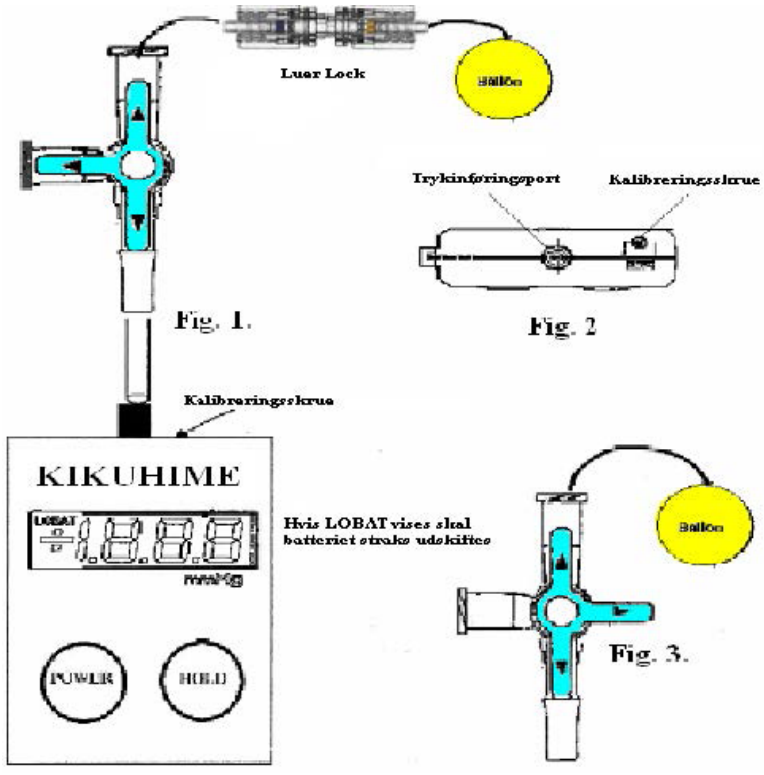

"Hold" knappen anvendes til at "fryse" et måleresultat

Anvendelsesområder

Subbandagetrykmåler til under kompressionsbandager og kompressions strømper

Anvendes til f.eks. oplæring af nyt personale. Kontrol af subbandagetryk, hvis man som ny behandler er usikker. Pædagogisk metode til at vise patienten, hvordan subbandagetrykket ændres under gang - motivere for motion af lægmuskel (muskel-venepumpe). Verificering af forskelligt subbandagetryk på malleol og bagved malleol - begrundelse for anvendelse af pelotter. Kontrol af kompressions-strømper f.eks.ved opfølgningsbesøg/efterbehandling (forebyggelse af nye venøse bensår).

Anlæggelse af bandage og glidestykke med håndtag (lille sensor)

Sensoren placeres i glidestykket med håndtag ca. 1 cm fra bunden. Placer glidestykket med sensor i ankelniveau. Dernæst an lægges forbinding og kompressionsbandage som vanligt. Nu kan subbanda-ge-trykket i ankel niveau aflæses på displayet. Fjern sensoren ved at trække i slange og Easy Glide.

Anvendelsesområder af den store sensor

Subbandagetrykmåler til under kompressionsbandager,Eks.: Oplæring af nye sårbehandlere, Check af subbanda-ge tryk, hvis man som ny sårbehandler er usikker, pædagogisk metode til at vise patien-ten,hvordan subbandage-trykket ændres under gang– motivere for motion af lægmuskel (muskel-ve-nepumpe) Vertificering af forskelligt subbandagetryk på malleol og bag ved malleol-begrundelse for oplæreing af nye sårbehandlerer.

Anlæggelse af bandage med glidestykke

Føleren placeres ca.2 cm fra bunden i et dobbelt glidestykke i ankelniveau. (Om muligt kan man bede patienten fastholde glidestykke og slange ved knæet). Dernæst an lægges forbinding og kompressi-onsbandage som vanligt. Nu kan subbandagetrykket i ankel niveau aflæses på displayet. Efter aflæs-ning kan føleren let og uden at bandagen ødelægges fjernes ved at række i slangen og det yderste stykke af det dobbelte glidestykke.Højere patient compliance ved anvendelse af kompressionsstrøm-per frem for bandager.- større sikkerhed for gradueret subbandagetryk. Man kan eventuelt foretage endnu en aflæsning lige under knæet, således at den graduerede kompression sikres.

Specifikationer

Kikuhime trykmåler	
Type	HPM - KH-01
Power-knap	Tænd/sluk funktion
Hold-funktion	"Fryser" måleresultatet
Måleområde	0-120 mmHg
Måling pr. sekund	Ca. 3 gange
Strømafbrydelse	Automatisk efter 3 minutter
Nøjagtighed	+/- 8 mmHg
Batteri	Brug kun ER6VM batterier - anden batteritype kan ødelægge apparatet eller give forkerte måleresultater
Rengøring	Rengør apparatet med en fugtig klud. Brug kun neutrale rengøringsmidler. Brug aldrig benzin. Sensorer må kun rengøres med alkohol.
Advarsel	Undgå at åbne batteridækslet på Kikuhime's bagside. I til fælde af behov for batteriskifte bør produktet returneres til TT-Meditrade.
	Type B patient del
Reklamation	Reklamationer på apparatet godtages inden for 2 år, (sensorer kun1 år) gældende fra købsdato. Garanti-ydelsen er begrænset til erstatning af materiale og fabrikationsfejl ved selve apparatet. Reklamationsretten bortfalder ved misbrug , uhensigtsmæssig behandling, ved indgreb, eller ved anvendelse af andet end almindelig luft
Varenr.	KKH-001

Kikuhime sæt indeholder

1 Kikuhime trykmåler
2 sensorer - stor og lille
1 kalibreringsskruetrækker
1 stk. Easy Glide (glidestykke) med håndtag
1 opbevaringstaske

TT Meditrade | ZiboCare Denmark
Præstemarksvej 67, DK-8700 Horsens
Denmark
Tlf.: +45 7879 7069
E-mail: info@ttmeditrade.dk
SE: 29610274